



Prefeitura de
Russas



TERMO DE JUNTADA

Junto aos autos contrarrazão da empresa
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA do
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 001.28.05.2021-SEMUS.

Data: 22 de junho de 2021.


Roberta Carlos Gonçalves Bezerra
Pregoeira do Município

PAÇO MUNICIPAL:
Av. Dom Lino, 831, Centro
CEP: 62.900-000
Fone: (88) 34118414
Site: www.russas.ce.gov.br
E-mail: licitação@russas.ce.gov.br



ILMO(A). PREGOEIRO(A) DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.28.05.2021-SEMUS

PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.485.574/0001-71, com sede na Av. Capitão Hugo Bezerra, nº 181, Barroso, Fortaleza- Ceará, Cep: 60.862-730, neste ato representado por seu Sócio Sr. JOSÉ RUFINO DA SILVA NETO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG nº 2007614588 – 8 SSP/CE e CPF nº 456.691.633-20, residente e domiciliado na Av. Coronel Miguel Dias, nº 1010, Torre A, apartamento 1402, Fortaleza/CE, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor a presente:

IMPUGNAÇÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Apresentado pela a empresa **ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES**, inscrita no CNPJ nº 02.626.340/0001-58, conforme as razões abaixo descritas de sua irrisignação:

I – DOS FATOS

Em face de Recurso, a empresa **ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES** requereu a reconsideração da decisão que julgou **CLASSIFICADA** a proposta apresentada pela a empresa **PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA**, pois segundo a empresa Recorrente, a Recorrida cotou/ofertou produto com especificação divergente ao solicitado pela a Administração.

Alega a **ART MÉDICA** que o produto (Gentle cath Glide/Convatec), apresentado pela a Prohospital, supostamente não atende o edital, visto que: i) não apresenta o calibre 12/18; ii) não possui bolsa coletora integrada ao cateter e iii) não é pronto para uso, em sua essência.

Desta feita, a Recorrente requer a nulidade do ato que habilitou e classificou a Prohospital para o Lote 01, diante do suposto descumprimento do edital, pois a marca sugerida não atende as especificações contidas no termo de referência, anexo ao instrumento convocatório.

JOSE RUFINO
DA SILVA
NETO:45669163
320
Assinatura de forma
digital por CCE
RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Data: 2021.05.22
15:00:43 -03'00'



Feita as considerações, a empresa PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA resolve por apresentar sua IMPUGNAÇÃO ao Recurso Administrativo, oportunidade em que se comprovará que as intenções da empresa Recorrente são infundadas e não refletem a realidade do produto, senão vejamos.

II - DO DIREITO

Primeiramente, cumpre destacar que a decisão do (a) Ilustre Pregoeiro(a) em classificar a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, ocorreu de forma acertada, estando a Recorrente querendo induzir a erro esta Comissão, ao afirmar que o produto Gentlecath Glide/Convatec, não atende as especificações contidas no instrumento convocatório.

A princípio, é importante esclarecer alguns pontos constantes no edital, no tocante ao objeto licitado, qual seja, AQUISIÇÃO DE CATETERES.

Conforme verifica-se a Administração Pública, descreveu os seguintes itens no seu termo de referência, vejamos:

LOTE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT. TOTAL
1	SPEEDICATH COMPACT SET MASCULINO Nº 12/18	CAIXA C/ 20 UNID.	1.620
2	SPEEDICATH COMPACT MASCULINO Nº 12/18	CAIXA C/ 30 UNID.	1.620
3	SPEEDICATH COMPACT SET FEMININO Nº 12	CAIXA C/ 20 UNID.	485
4	CATETER URETRAL SPEEDICATH STANDARD FEMININO Nº 10	CAIXA C/ 30 UNID.	360
5	SPEEDICATH STANDARD INFANTE Nº 3	CAIXA C/ 30 UNID.	250

DE ANTEMÃO, CUMPRE DEMONSTRAR QUE ACREDITA-SE TER HAVIDO UM EQUIVOCO NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, AO CITAR SPEEDICATH, POIS O MESMO, NA VERDADE, É UM NOME COMERCIAL DE UM TIPO DE CATETER DA FABRICANTE COLOPLAST, CONFORME VERIFICA-SE ABAIXO:


JOSE RUFINO
DA SILVA
NETO:4566916
3320

Assinado de forma
digital por JOSE
RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Data: 2021.06.22
15:02:17 -0300



ITEM 01:

Home > Continência > Fôros > Urológico > Produtos

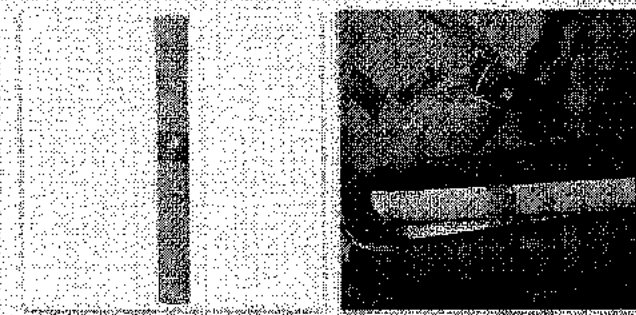

SpeediCath® Compact Set Masculino

O SpeediCath Compact é um cateter de inserção rápida e de remoção fácil. Para quem deseja uma inserção simples, econômica e rápida. Cateter à base de látex com lubrificação. Características: inserção rápida e fácil, não necessita de lubrificação adicional e não necessita de anestesia local.

Aplicação indicada:
 Urológico - Masculino - 20/18/60

Quantidade por pacote: 20
Quantidade de pacotes por caixa: 05

Fonte: <https://produtos.coloplast.com.br/coloplast/continencia/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-masculino/>

ITEM 02:

Home > Continência > Fôros > Urológico > Produtos



SpeediCath® Compact Masculino

O SpeediCath Compact é um cateter de inserção rápida e de remoção fácil. Para quem deseja uma inserção simples, econômica e rápida. Cateter à base de látex com lubrificação. Características: inserção rápida e fácil, não necessita de lubrificação adicional e não necessita de anestesia local.


Aplicação indicada:
 Urológico - Masculino - 20/18/60

Quantidade por pacote: 20
Quantidade de pacotes por caixa: 05


Fonte: <https://produtos.coloplast.com.br/coloplast/continencia/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-masculino/>

ITEM 03:

JOSE RUFINO DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163
 320



Estoque Continência Fértil Urólogo Produtos



SpeediCath® Compact Set Feminino

O SpeediCath Compact Set Feminino é a escolha ideal para cateter, devido à sua construção ultraleve e ultrablanda, com o menor e maior diâmetro interno. Construído em material de alta qualidade, oferece ao seu usuário o máximo conforto e segurança.


Opções de produto:

Modelo: Feminino - 9.712
 Preço por caixa: 70
 Quantidade de unidades SpeediCath: 19

Fonte: <https://produtos.coloplast.com.br/coloplast/continencia/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-feminino/>

ITEM 04:

Estoque Continência Fértil Urólogo Produtos



SpeediCath® Compact Feminino

O SpeediCath Compact Feminino é um cateter com revestimento hidrofóbico e antiobstrução para cateterização. Seu design inovador garante o máximo conforto e segurança.


Opções de produto:

Modelo: Feminino - 6911
 Preço por caixa: 70
 Quantidade de unidades SpeediCath: 19

Fonte: <https://produtos.coloplast.com.br/coloplast/continencia/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-feminino/>


ITEM 05:

JOSE RUFINO DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO: 45669163320
 320
 Data: 2021.06.23 15:08:43-03'00'



Coloplast - Cateteres - Fêmeas - Urinária - Produtos

Produtos > Produtos Urinários > Urinária > Fêmeas



SpeediCath® infantil

Cateteres de drenagem urinária para uso pediátrico. São cateteres de drenagem urinária com filtro para prevenir o refluxo de urina e evitar o crescimento bacteriano. Disponível em versões masculina e feminina.

Opções de produto:

2x 10 - Pacote(s) 10x1 - Quantidade: 20x

Maximização: 10

Duração de validade (dias): 36

Fonte: <https://produtos.coloplast.com.br/coloplast/continencia/speedicath/speedicath-standard/speedicath-infantil/>

Assim, conforme telas acima colacionadas, fica demonstrado que SPEEDICATH é o nome comercial da marca COLOPLAST, sendo o cateter, o produto.

Na verdade, resta claro que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS-CE, busca efetuar a aquisição de cateteres, contudo, ao realizar o descritivo no seu termo, equivocou-se no seu termo, sendo o correto a seguinte descrição:

- Item 01 - Cateter hidrofílico masculino TAM 12
- Item 02 - Cateter hidrofílico masculino TAM 12
- Item 03 - Cateter hidrofílico feminino TAM 12
- Item 04 - Cateter hidrofílico feminino TAM 10
- Item 05 - Cateter hidrofílico TAM 08

Por óbvio, que a intenção deste órgão JAMAIS seria direcionar o certame para a marca, caso contrário, estaria restringindo, sem qualquer justificativa legal, a ampla participação, bem como ferindo os princípios da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa.

Um dado importante a se destacar, refere-se a ao tipo do modelo Compact/Compact Set (cateter + Bolsa coletora)/ Standart), diga-se, exclusivo da Coloplast.

O Compact é um cateter mais rígido e mais compacto. Já o modelo Compact Set é o único que acompanha a bolsa coletora integrado no cateter, sendo esta a descrição para os itens 01 e 03.

No entanto, é sabido que a finalidade da bolsa coletora é apenas a praticidade do uso para dispensação da urina, no entanto, não modifica a indicação e a funcionalidade do cateter, podendo a urina ser dispensada no vaso, em um recipiente, ou um saco coletor, por exemplo.

JOSE RUFINO DA SILVA
Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA NETO: 456691633
Data: 2023.05.22 15:01:41 -03'



Ademais, o cateter Compact Set tem um valor de mercado bem maior, com isso, o custo da sua aquisição, aumentaria de forma considerável à Administração, pois todos são descartáveis e, a depender do paciente, são utilizados vários cateteres por dia.

Pois bem. Dito isso, a PROHOSPITAL participou do presente certame, visto já ter larga experiência em processo licitatório desta natureza, tendo ofertado o produto GENTLECATH GLIDE da marca CONVATEC, onde a Recorrente aduz que a mesma não cumpriu com as especificações do edital, relativamente nos seguintes pontos:

- i) não apresenta o calibre 12/18;
- ii) não possui bolsa coletora integrada ao cateter e
- iii) não é pronto para uso, em sua essência.

Contudo, passa-se a rebater cada argumento, de forma que não haja dúvida que o produto GENTLECATH GLIDE da marca CONVATEC, ofertado pela a PROHOSPITAL, atende ao termo de referência, bem como a necessidade do órgão, portanto, descabida a pretensão da Art Médica.

Com o fito de uma maior transparência acerca do produto/marca ofertada, julga-se necessário uma breve apresentação do mesmo.


O GENTLECATH GLIDE, trata-se de um cateter urinário totalmente hidrofílico por ter os aditivos hidrofílicos incorporados em sua composição, ou seja, **NÃO NECESSITA DE REVESTIMENTO COM PVP** para tornar-se hidrofílico. Isto significa que **TODA A SUPERFÍCIE DO CATETER GENTLECATH GLIDE** possui propriedade hidrofílica, o que dispensa a necessidade ou o uso de lubrificação externa, garantindo, assim, uma pré-lubrificação, o que torna a superfície lisa e escorregadia de maneira uniforme.

No tocante a sua composição, cumpre esclarecer que tanto o POBE quanto os POLIURETANOS, são polímeros elastoméricos derivado de plásticos, porém, os polímeros elastoméricos base de Poliolefina (POBE), são os únicos materiais derivados do plástico que suportam altas exposição, alta resistência, atóxicos, não contaminantes, de baixa adesividade, e possuem maior biocompatibilidade quando comparado aos POLIURETANOS, diga-se, materiais que compõe a fabricação do SPEEDICATH.

Por conseguinte, aduz a Recorrente que o produto ofertado não é pronto para uso, o que cumpre tecer algumas considerações, vejamos.

Um cateter totalmente pronto para uso, é aquele em que não há necessidade de o usuário tocar no cateter antes de introduzi-lo no canal uretral, como por exemplo os não hidrofílicos, onde o usuário precisa tocá-lo para lubrificar o cateter antes de realizar o cateterismo.

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO: 45669163320
320
Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO: 45669163320
Data: 2021.05.22 13:01:33 -03'00'



O cateter GENTLECATH GLIDE tem a presença de manga de proteção que permite utilizá-lo com a técnica sem toque, portanto, minimiza o contato direto com o cateter, reduzindo o risco de contaminação por bactérias presentes nas mãos. Além disso, permite a inserção do cateter de forma fácil e precisa durante o procedimento de cateterismo vesical.

Quando a água estéril do sachê entra em contato com o cateter, cria-se instantaneamente uma superfície lisa e escorregadia, que reduz o atrito entre o cateter e o canal uretral durante a inserção, minimizando riscos de trauma da uretra e infecção do trato urinário.

O GENTLECATH GLIDE, é armazenado em recipiente estéril, sendo aberto apenas no momento do uso. Por não necessitar de lubrificação externa e por possuir uma manga de proteção limita o contato manual, e assim menos propenso a provocar infecção.

Para Sociedade Brasileira de Urologia (2017); O desenvolvimento dos cateteres hidrofílicos facilitou a técnica de cateterismo sem toque, proporcionando benefícios em termos de contaminação externa, e ainda, com a presença de líquido estéril pré-embalado com o cateter passa ser conhecido como cateteres pronto para uso.

Sendo assim, resta claro que o GENTLECATH GLIDE é um cateter pronto par uso. Estas informações, constam nas instruções de uso que acompanham o produto, ora em anexo, bem como verifica-se na notificação ANVISA Nº. 80523020075, demonstrando assim todo o alegado.

Destaca-se que o GENTLECATH GLIDE, é uma nova geração de cateter urinário hidrofílico, que foi desenvolvido para tornar o cateterismo intermitente mais rápido por estar pronto para o uso e eliminar a necessidade de espera, bem mais seguro, pois é produzido por meio da Tecnologia FeelClean que, além do baixo coeficiente de fricção que reduz o atrito, apresenta uma menor extração de resíduos durante o cateterismo, além de ser descomplicado por ser de manuseio fácil e preciso, sem tornar-se pegajoso.

Quanto suposta alegação de que o produto não apresenta o calibre 12/18, primeiramente esclarece-se que a Sociedade Brasileira de Urologia - SBU, enfatiza que estes podem variar de 6 a 12 Fr para crianças, de 10 a 14 Fr para homens e 10 a 16 Fr para mulheres.

Em pacientes com urina piúrica ou submetidos à ampliação vesical podem ser necessários cateteres com calibres ou orifícios maiores. De um modo geral, o cateter calibre 12 Fr é utilizado pela maioria dos pacientes. Para mulheres, o comprimento do cateter pode ser menor, o que facilita seu uso e armazenamento.

Conforme catálogo, também em anexo, resta comprovado que a GentleCath Glide apresenta como opções de calibres: 8 a 12Fr (feminino), 10 a 16Fr (masculino), portando, cumprindo ao disposto no termo de referência.

Assim, o contrário do que diz a empresa Recorrente, o produto (GentleCath Glide/Convatec) apresentado é um cateter hidrofílico, com dois orifícios polidos na guia de inserção, pronto para uso do